



تعليمات الاستخدام
للعيادات GLOOKO®

المحتويات

3.....	الاستخدام المقصود
3.....	المستخدمون المستهدفون
3.....	موانع الاستخدام
3.....	الفوائد السريرية
3.....	التحذيرات

1. كيفية البدء باستخدام Glooko®

1.1. خصائص الأداء

2.1. التوافق

4..... نظام التشغيل

4..... توافق الجهاز

5..... تكنولوجيا المعلومات والأمن

3.1. تحديد أداة التحميل المستخدمة في العيادة

4.1. تحميل بيانات مرض السكري الخاصة بالمريض وعرضها

6..... الخطوة 1: توصيل جهاز مرض السكري وتحميله

7..... الخطوة 2: تعيين بيانات جهاز لأحد المرضى

8..... الخطوة 3: احصل على نظرة عامة على مجموعة المرضى لديك باستخدام لوحة معلومات العيادة*

10..... الخطوة 4: عرض بيانات مرض السكري الخاصة بالمريض

2. نظرة عامة على Population Tracker

1.2. إنشاء حسابات المرضى

2.2. مرضى ProConnect

3.2. وضع الوسوم على المرضى

4.2. تصفية وتقسيم المرضى

5.2. الدعوة من قائمة المرضى

6.2. إدارة إعدادات المقدم

21..... ملف تعريف

21..... الحساب

21..... ملف تعريف الموقع

22..... إعدادات البيانات

23..... إعدادات PDF المفضلة

7.2. إدارة إعدادات المريض

24..... ملف التعريف

25..... الحساب

26..... إعدادات البيانات

27..... الأجهزة

29	إدارة الحساب
30	3. نظرة عامة على التقارير
30	1.3. التقارير المتوفرة
30	2.3. إنشاء التقارير
32	4. الدعم
33	الملحق 1: الميزات الإضافية
33	أ. إخفاء قائمة المرضى
34	أ.2. نسخ الإحصاءات الأساسية*
34	أ.3. *Glooko Clinical Research
34	معرف المشارك
35	إخراج مريض
35	Research Uploader
36	أ.4. التحقق على خطوتين
37	أ.5. تسجيل الدخول الأحادي
38	أ.6. Care Programs
38	أ.7. حزمة الحمل
39	أ.8. إنشاء مجموعات المرضى
40	الملحق 2: ميزات خاصة بالأجهزة
40	أ.1. Basal-IQ
40	أ.2. Control-IQ
41	أ.3. نظام 5 *OmniPod®
42	أ.4. *CamAPS FX

الاستخدام المقصود

تطبيق Glooko Web Application هو منصة لإدارة مرض السكري يمكن استخدامها في العيادة أو عن بُعد من قبل اختصاصيي الرعاية الصحية والمرضى. وهو يتيح عرض بيانات المرضى من الأجهزة الطبية المتوافقة وأجهزة المراقبة الصحية الأخرى. كما أنه يسمح لاختصاصيي الرعاية الصحية بدعم علاج مرض السكري عن طريق تحليل علاج مرض السكري وبرنامج رعاية المريض. صُمم Glooko Mobile ليستخدمه الأفراد المصابون بمرض السكري.

المستخدمون المستهدفون

صُمم Glooko Web Application ليستخدمه المتخصصون في الرعاية الصحية ومرضاها. فئة المرضى المستهدفة هي الأشخاص المصابون بمرض السكري.

موانع الاستخدام

غير معروفة.

الفوائد السريرية

قد يحظى المرضى الذين يستخدمون Glooko System بالفوائد السريرية الآتية:

- تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم
- تحسين A1C
- تحسينات مستمرة لنسبة السكر في الدم

التحذيرات

لا يقيس Glooko البيانات التي ينقلها أو يفسرها أو يتخذ القرارات بشأنها، كما أنه غير مصمم لتقديم قرارات علاج تلقائية ولا لاستخدامه كبديل للرأي المهني. من هنا، يجب إجراء أي تشخيص طبي أو علاج طبي تحت إشراف مقدم رعاية صحية ملائم ومراقبته.

1. كيفية البدء باستخدام Glooko®

Glooko هي منصة موحدة لإدارة مرض السكري تقوم بمزامنة بيانات الجلوكوز وغيرها من البيانات المتعلقة بالصحة بطريقة بسيطة من أجهزة قياس جلوكوز الدم (BG) الشائعة ومضخات الإنسولين وأقلام Smart Pen وأجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) وأجهزة الصحة واللياقة البدنية. ويوفر حل Glooko معلومات معمقة رئيسية حول العلاقات التي تربط توجهات الجلوكوز لدى المريض مع كمية الكربوهيدرات التي يتناولها وجرعات الإنسولين والتمارين الرياضية وغيرها من المقاييس الحيوية – ومن شأن ذلك تمكين فرق الرعاية الصحية من اتخاذ قرارات مدروسة أكثر من شأنها تحسين جودة رعاية مرض السكري بشكل عام. من خلال تسليط الضوء على المشاكل، يمكّن Glooko مقدمي الرعاية من تحسين حالات كل مريض السكري لديهم وإدارتها بفعالية أثناء المواعيد وبينها.

ملاحظة: قد تختلف بعض الشاشات وفقًا للميزات الإضافية التي تتم إضافتها إلى اشتراكك. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع [الملحق 1: الميزات الإضافية](#).

1.1. خصائص الأداء

يحافظ تطبيق Glooko Web Application على حد أدنى من وقت تشغيل الخدمة بنسبة 99%.

2.1. التوافق

نظام التشغيل

يدعم Glooko الإصدارات التالية من مستعرضات الويب:

- الإصدار 87 من Google Chrome أو أحدث
- الإصدار 94 من Microsoft Edge أو أحدث
- الإصدار 78 من Firefox أو أحدث
- الإصدار 11.1 من Safari أو أحدث

للحصول على أفضل أداء، ننصح باستخدام Google Chrome.

توافق الجهاز

لتحديد توافق جهاز مرض السكري الذي يستخدمه المريض، راجع صفحة [التوافق مع Glooko](#). يتكون Glooko System الكامل من منتجات Glooko الآتية:

- (REF-0001) Glooko Web Application
- (REF-0002) Glooko Mobile Application
- تطبيق (REF-0009) Glooko Research

* قد لا يكون متوفرًا في بلدك.

تكنولوجيا المعلومات والأمن

يتطلب Glooko اسم مستخدم وكلمة مرور للمستخدمين المحترفين للدخول إلى حساباتهم. لا تشارك اسم المستخدم أو كلمة المرور الخاصة بك مع أي شخص. ويوصى بتنفيذ عملية التحقق على خطوتين (راجع القسم 8).

3.1. تحديد أداة التحميل المُستخدمة في العيادة

تختلف عملية تحميل بيانات مرض السكري لكل مريض استنادًا إلى أداة التحميل المُستخدمة في العيادة. راجع تعليمات الاستخدام المناسبة للحصول على تعليمات مفصلة حول كيفية استخدام كل أداة لتحميل البيانات:

- [Glooko Transmitter](#)
- [Glooko Uploader](#)

4.1. تحميل بيانات مرض السكري الخاصة بالمريض وعرضها

بعد تكوين صورة واضحة عن توافق جهاز مرض السكري وأداة التحميل التي يتم استخدامها في عيادتك، اتبع الخطوات الموصوفة أدناه للبدء في تحميل بيانات مرض السكري الخاصة بالمريض إلى Glooko:

ملاحظة: قد يؤدي ضبط الوقت أو التاريخ الخاطئ على جهاز مرض السكري إلى حدوث مشكلات عند محاولة المزامنة مع Glooko. عند عرض بيانات المريض لأول مرة ضمن تطبيق Glooko Web App، تأكد من أن الطوابع الزمنية للبيانات ضمن التطبيق تتوافق مع الطوابع الزمنية على جهاز مرض السكري الخاص بالمريض. من علامة التبويب **الأجهزة** في حساب المريض، يمكنك التأكد من عدم وجود تنبيه تفاوت وقت (رمز الساعة) للأجهزة التي تم تحميلها فعليًا.

The screenshot shows the Glooko web application interface. At the top, there is a blue header with the Glooko logo on the right and a user icon labeled 'LT' on the left. Below the header, a navigation bar contains several tabs: 'الملخص' (Summary), 'الرسومات البيانية' (Charts), 'السجل' (Log), 'المحفوظات' (Favorites), 'المعلومات المعقدة' (Complex Information), and 'الأجهزة' (Devices). The 'الأجهزة' tab is highlighted with an orange box. The main content area shows patient information for 'Lucy Test' (Lucy Test) with a 'MrnCustomLabel' and a date of birth '1970.01.01'. Below this, there are links for 'Omnipod® PDM' and 'PDF'. The 'الأجهزة' section displays a list of connected devices. The first device, 'Ascensia CONTOUR NEXT ONE', is highlighted with an orange box and shows a time difference of '+00:59'. The second device, 'Dexcom', is shown as connected with a last sync time of '31 أكتوبر 2025 - 10:52'. The third device, 'Ascensia CONTOUR NEXT ONE', is shown with a last sync time of '23 فبراير 2025 - 16:15'.

الخطوة 1: توصيل جهاز مرض السكري وتحميله

قم بتوصيل جهاز مرض السكري الخاص بالمريض باستخدام أداة التحميل المستخدمة في العيادة وابدأ بعملية التحميل وفقًا للخطوات الموضحة في تعليمات الاستخدام الملائمة.

عندما يتم تحميل بيانات جهاز مرض السكري، انتقل إلى الموقع my.glooko.com في مستعرض الويب وسجل الدخول إلى Population Tracker لتعيين البيانات التي تم تحميلها أو عرضها.

ملاحظة: إذا تم تمكين تسجيل الدخول الأحادي للعيادة، فانقر فوق تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الأحادي، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك واتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة. يمكن لاختصاصيي الرعاية الصحية المتصلين بعيادات متعددة تسجيل دخولهم باستخدام بيانات الاعتماد نفسها، ثم اختيار العيادة التي يريدونها بعد تسجيل الدخول. ويتوفر خيار تغيير العيادة في قائمة منسدلة في الزاوية العلوية اليمنى حيث يتم عرض رمز ProConnect.

glooko

تسهيل إدارة مرض السكري

▼

تسجيل الدخول

البريد الإلكتروني (اسم المستخدم)

كلمة المرور

يجب أن تضم كلمة المرور 8 أحرف على الأقل ورمزًا واحدًا وحرفًا خاصًا واحدًا من الأحرف التالية (*&^%\$#@!)

نسيت كلمة المرور?

لم تلتق تعليمات إعداد التفل؟

تسجيل الدخول

تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الأحادي

ليس لديك حساب؟ التسجيل في Glooko هنا

الخطوة 2: تعيين بيانات جهاز لأحد المرضى

ملاحظة: تنطبق هذه الخطوة فقط على مستخدمي Glooko Transmitter و Uploader. ويمكن لكافة المستخدمين الآخرين التخطي إلى [الخطوة 3](#).

تعيين الأجهزة

انقر فوق علامة التبويب **تعيين الأجهزة** لعرض قائمة بكافة الأجهزة التي تم تحميلها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. سيتوفر لك هنا الخيار للتصفية حسب **الطرفية** (الرقم التسلسلي) أو **نوع الجهاز** (جهاز مراقبة مستمرة للجلوكوز أو جهاز قياس أو مضخة).

وسيحاول Glooko مطابقة الأجهزة التي تم تحميلها مع أحد المرضى وفقًا لرقم الجهاز التسلسلي.

- إذا تم العثور على تطابق: فسيتم توفير لك خيار **التعيين لـ [اسم المريض]** أو **التعيين لمريض آخر**.
 - وبعد النقر فوق **التعيين لمريض آخر**، ستتم مطالبتك بالبحث عن حساب مريض موجود أو [إنشاء حساب مريض جديد](#).
 - إذا لم يتم العثور على تطابق: فسيتم وضع علامة على الجهاز للإشارة إلى أنه **جهاز جديد**، وسيتم توفير لك خيار **التعيين**.
 - وبعد النقر فوق **التعيين**، ستتم مطالبتك بالبحث عن حساب مريض موجود أو [إنشاء حساب مريض جديد](#).
- بمجرد تعيين جهاز، سيتم نقل حالته من غير معين إلى معين مؤخرًا. وسيتم توفير لك خيار عرض حساب المريض أو **إنشاء تقرير أو إلغاء التعيين**.

عرض المرضى		تعيين الأجهزة	
تحديث القائمة	نوع الجهاز	الجهاز	تصفية بواسطة
	جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز...		
نوع الجهاز	آخر مراجعة	التعيين	غير مُعَيَّن
Tandem T:slim X2 مضخة 494630	09:52	جهاز جديد	تعيين
Dexcom G5 جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز DX53709076	09:50	جهاز جديد	تعيين
المعينة مؤخرًا			
Ascensia Contour Next One جهاز قياس 7802H6154686	09:50	Lucy Test 1970/01/01	إنشاء تقرير إلغاء التعيين

ملاحظة:

لمنع حدوث أخطاء وتناقضات في البيانات، تحظر Glooko الآن إجراء تعيينات متعددة للأجهزة في وقت واحد لنفس المريض. إذا كان هناك تعيين لجهاز قيد التنفيذ بالفعل، فسيتم تعطيل كل خيارات التعيين لهذا المريض مؤقتاً حتى يتم الانتهاء من التعيين الحالي أو إلغاؤه.


إلغاء تعيين الأجهزة

إذا قمت بتعيين جهاز عن طريق الخطأ وكنت تحتاج إلى إلغاء تعيينه من حساب أحد المرضى، فانقر فوق **إلغاء التعيين** إلى جانب الجهاز في القسم الذي تم تعيينه مؤخراً. ستنتقل هكذا حالة الجهاز من "معين مؤخراً" إلى "غير معين"، وستتم إزالة كل البيانات المتعلقة بعملية التحميل هذه من حساب المريض. بعد ذلك، سيتوفر لك خيار تعيين الجهاز لمريض آخر.

ملاحظة: انقر فوق **تحديث القائمة** لتحديث قائمة الأجهزة المعينة وغير المعينة.

الخطوة 3: احصل على نظرة عامة على مجموعة المرضى لديك باستخدام لوحة معلومات العيادة*

توفر لوحة معلومات العيادة لاختصاصيي الرعاية الصحية رؤية مركزية لمجموعة المرضى في عيادتهم. وتعرض بياناتٍ من الأيام الأربعة عشر الماضية ويتم تحديثها يوميًا.

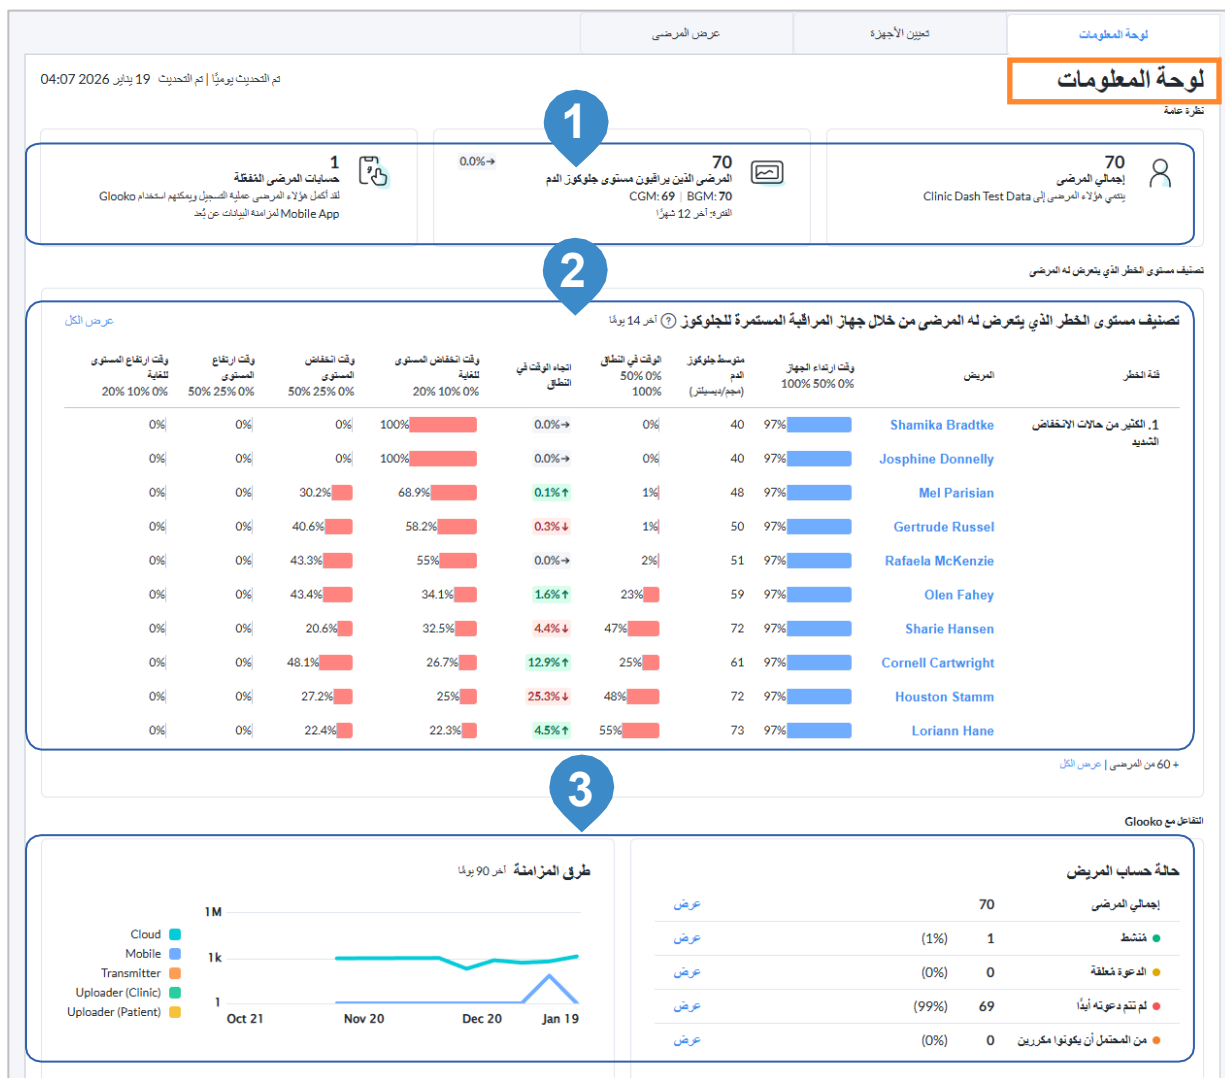

تتوفر لوحة المعلومات كعلامة تبويب في Population Tracker وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية:

1. نظرة عامة:

يعرض هذا القسم المقاييس الرئيسية التي تلخص الحالة الحالية لمجموعة مرضى العيادة:

- إجمالي المرضى: العدد الإجمالي للمرضى في Population Tracker، بما في ذلك النسبة المئوية للتغيير في آخر 14 يومًا.

- **المرضى الذين يراقبون مستوى جلوكوز الدم:** عدد المرضى الذين يستخدمون أجهزة المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) أو أجهزة قياس الجلوكوز في الدم (BGM)، مع إظهار النسبة المئوية للتغيير في آخر 14 يومًا. يتم فقط تضمين المرضى الذين لديهم إدخال بيانات واحد على الأقل في العام الماضي.
- **حسابات المرضى المُفعّلة:** إجمالي عدد المرضى الذين نشطوا حساباتهم.

2. تصنيف مستوى الخطر الذي يتعرض له المرضى من خلال جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز

يعرض هذا القسم ملخصًا لأول 10 مرضى في تصنيف المرضى وفقًا للمخاطر السريرية، وذلك استنادًا إلى بيانات جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM). ويتم تصنيف هؤلاء المرضى في مجموعات معرضة للخطر للمساعدة في تحديد أولويات الرعاية. يتيح خيار "View All" (عرض الكل) للمستخدمين الوصول إلى قائمة المرضى الكاملة.

يظهر كل إدخال مريض:

- اسم المريض
- مدة الارتداء (النسبة المئوية من وقت ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM))
- متوسط جلوكوز الدم (مجم/ديسيلتر)
- الوقت في النطاق (النسبة المئوية للوقت في النطاق)
- اتجاه الوقت في النطاق (التغير في الوقت في النطاق مقارنةً بفترة الأسبوعين السابقين)
- الوقت أقل من النطاق:
 - أقل من 70 مجم/ديسيلتر
 - أقل من 54 مجم/ديسيلتر
- الوقت أعلى من النطاق:
 - أعلى من 180 مجم/ديسيلتر
 - أعلى من 250 مجم/ديسيلتر

يتم تجميع المرضى وإعطائهم الأولوية حسب فئات المخاطر التالية:

1. **الكثير من حالات الانخفاض الشديد:** في <1% من الوقت، يكون أقل من 54 مجم/ديسيلتر (عند ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بنسبة تتعدى الـ 50%)
2. **الكثير من حالات الانخفاض:** في <4% من الوقت، يكون أقل من 70 مجم/ديسيلتر (عند ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بنسبة تتعدى الـ 50%)
3. **مرتفع جدًا:** في <5% من الأوقات، يكون أعلى من 250 مجم/ديسيلتر (عند ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بنسبة تتعدى الـ 50%)
4. **انخفاض كبير في الوقت في النطاق:** انخفاض معدل الوقت في النطاق بنسبة <15% مقارنةً بالأسبوعين السابقين
5. **مرتفع:** في <25% من الوقت، يكون أعلى من 180 مجم/ديسيلتر (عند ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بنسبة تتعدى الـ 50%)
6. **وقت في النطاق منخفض:** الوقت في النطاق >65%
7. **بيانات مفقودة/غير كافية:** تم ارتداء جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز (CGM) بنسبة أقل من 50%
8. **لا توجد إنذارات:** لا يستوفي المريض أيًا من معايير المخاطر المذكورة أعلاه

3. التفاعل مع Glooko

يساعد هذا القسم على تتبع تفاعل المريض مع منصة Glooko.

حالة حساب المريض:

- يعرض عدد المرضى الذين يندرجون ضمن الفئات التالية:

- مُنشط
- الدعوة مُعلقة
- لم تتم دعوته أبدًا
- من المحتمل أن يكون مكرّرًا

- ويمكن النقر فوق كل حالة لتصفية قائمة المرضى.

طرق المزامنة (آخر 90 يومًا):

- يظهر رسمًا بيانيًا خطيًا للطريقة التي استخدمها المرضى لمزامنة البيانات من خلال:

- السحابة
- الهاتف المحمول
- جهاز إرسال
- Uploader (العيادة)
- Uploader (المريض)

* قد لا تكون متوفرة في بلدك.

الخطوة 4: عرض بيانات مرض السكري الخاصة بالمرضى

عرض المرضى

تعرض قائمة المرضى قائمةً بكل المرضى المتصلين عبر ProConnect بعيادتك (أي المتصلين عبر [رمز ProConnect](#) الفريد الخاص بعيادتك). ومن شأن ذلك توفير نظرة سريعة على مجموعة المرضى لديك.

للعثور على مرضى معينين، حدد الاسم أو رقم السجل الطبي (MRN) أو تاريخ الميلاد من القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة وأدخل معايير البحث في حقل البحث. يمكنك كذلك النقر فوق كل أدوات التصفية لتصفية نتائجك وفقاً للوسوم أو لسمات أخرى أو فرز المرضى من خلال النقر فوق أي من عناوين الأعمدة.

سيُظهر عمود آخر مزامنة رمز منزل للمرضى الذين قاموا بآخر مزامنة في المنزل ورمز عيادة لأولئك الذين قاموا بآخر مزامنة في العيادة. كما أنه سيُظهر عدد الأيام منذ آخر مزامنة واسم الجهاز الذي تمت مزامنته.

سيُظهر عمود الوقت في النطاق النسبة المئوية للوقت الذي يكون فيه المرضى ضمن نطاقهم المستهدف. إذا مررت الماوس فوق النسبة المئوية، فستظهر تفاصيل إضافية، مثل نطاق التاريخ ومتوسط القراءات اليومية والنطاق المستهدف.

ويوفر تطبيق Population Tracker خيارات للتصفية والتتبع من ضمنها إمكانية إنشاء الوسوم المخصصة ودعوة المرضى من قائمة المرضى.

Demo Diabetes Clinic رمز ProConnect: 7654321				الاسم	أدخل اسم المريض
إتة	عرض المرضى	تحليل الأجهزة	لوحة المعلومات		
		الحسابات المكررة	الوسوم	كل عوامل التصفية	
المرضى	آخر مزامنة	الوقت في النطاق	الوسوم	المريض	
B. Phillips	✓	%19	Ascensia CONTOUR NEXT ONE	Lucy Test	1970.07.20 كشط
M. Williams	✓	%76	FreeStyle Insulinx	George Testerson	1973.03.03 كشط
+		%67	OneTouch Verio	Sally Testing	1983.02.01 إعادة إرسال الدعوة

الحسابات المكررة

باعتبارك مسؤولاً في عيادتك، لديك القدرة على تحديد الحسابات المكررة وإزالتها. اتبع الخطوات أدناه لتحديد الحسابات المكررة المحتملة وإزالتها.

ابabetes Clinic رمز: ProConnect		الاسم	أدخل اسم المريض
عرض المرضى		تحديد الأجهزة	لوحة المعلومات
المريض		أمر مزمنة	الوقت في المكان
الوسوم		الحسابات المكررة	الوسوم
Philips	✓	%19	Ascensia CONTOUR NEXT ONE
Williams	✓	%76	FreeStyle InsulinX
+		%67	OneTouch Verio
Lucy Test		1970.07.20 كخط	
George Testerson		1973.03.03 كخط	
Sally Testing		1983.02.01 إعادة إرسال الدعوة	

1. انقر فوق زر الحسابات المكررة في علامة التبويب عرض المرضى.
2. ستظهر قائمة بالحسابات المكررة المحتملة. انقر فوق إصلاح للمراجعة أكثر.
3. راجع الحسابات المكررة المحتملة ومقاييسها التعريفية، مثل الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد وأي أجهزة تمت مزامنتها في الماضي. على اليمين، اختر إبقاء أو إزالة لإبقاء الحساب أو إزالته.
4. لديك أيضًا خيار تعديل معلومات المريض التالية: الاسم الأول واسم العائلة وتاريخ الميلاد ورقم السجل الطبي.
5. عند الانتهاء من تعديل الحسابات ومراجعتها، اضغط على مراجعة التغييرات.
6. سيتم عرض ملخص للتغييرات. حدد المربع لتأكيد أنك تفهم أن التراجع عن هذه التغييرات غير ممكن، ثم اضغط على حفظ.
7. ستتم الآن إزالة الحسابات المكررة المحددة.
8. واصل مراجعة الحسابات المكررة المحتملة الأخرى أو اضغط على زر الحسابات المكررة X للعودة إلى طريقة عرض المرضى القياسية.

ملاحظة:

- يوصى بالاحتفاظ بحساب مريض واحد على الأقل لكل مستخدم فريد.
- إذا كانت حالة حساب أحد المرضى موسومة بعلامة غير مفعّل واخترت إزالة هذا الحساب، فسيتم حذفه نهائيًا.
- إذا كانت حالة حساب أحد المرضى موسومة بعلامة مفعّل، فسيتم إبلاغ المريض عبر البريد الإلكتروني بأن حسابه لم يعد متصلًا بعيادتك عبر ProConnect. سيظل المريض قادرًا على الوصول إلى حساب Glooko الخاص به وبياناته الشخصية. لكنه لن يعود قادرًا على الوصول إلى أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية تم تمكينها بواسطة العيادة.

ملخص المريض

انقر فوق مريض ليتم نقلك إلى ملخص المريض الذي يوفر لك لمحة عن بيانات مرض السكري الخاصة بالمريض.

يمكنك عرض بيانات إضافية من خلال التبديل بين علامات التبويب في شريط التنقل العلوي – ويمكنك إنشاء [تقارير PDF](#) لطباعة تلك البيانات أو مشاركتها أو حفظها. في كل صفحات المرضى، يتم عرض تاريخ الميلاد ورقم السجل الطبي ((MRN) Medical Record Number)) تحت اسم المريض للمساعدة في ضمان عرض المريض الصحيح.

ملاحظة: إذا كان لدى المريض اتصال سحابي مع Senseonics Eversense أو Medtrum، فقد تحتاج إلى الانتقال إلى صفحة الأجهزة والنقر فوق زر **مزامنة الجهاز** لتتمكن من رؤية أحدث البيانات. تتم مزامنة البيانات من اتصالات السحابة هذه تلقائيًا كل ليلة. لكن إذا أردت رؤية بيانات من اليوم الحالي، فعليك النقر فوق الزر لاسترداد هذه البيانات.

انقر فوق **ملف التعريف** في أعلى يسار الشاشة لعرض **إعدادات المريض** وإدارتها.



معلومات عن الأنسولين :

ستُعرض بيانات مضخة الأنسولين وبيانات القلم الذكي باسم **الأنسولين – جهاز** وستُعرض بيانات الأنسولين المدخلة يدويًا باسم **الأنسولين – يدويًا**. إذا كان لدى المريض مضخة مزودة بتقنية متقدمة يمكنها إيقاف الضخ تلقائيًا و/أو تقديم الأنسولين تلقائيًا، فستعرض صفحة الملخص بطاقة معلومات إضافية بعنوان **تفاصيل النظام** أسفل "الأنسولين". يُرجى الرجوع إلى **الملحق 2: الميزات الخاصة بالأجهزة** للحصول على مزيد من المعلومات.

اكتشاف الطلقات التحضيرية*

معلومات عامة (تتطبق على معظم الأقلام الذكية المتوافقة وملحقات الأقلام المزودة بالأنسولين) ستتم الإشارة إلى بيانات قلم الأنسولين الآتية من الأقلام الذكية التي تم اكتشافها كجرعة أولية بواسطة خوارزمية الجرعات الأولية من Glooko على أنها جرعة أولية في سجل المحفوظات. ويكتشف برنامج اكتشاف الطلقات التحضيرية من Glooko جرعات أولية تكون أقل بوحدين أو أكثر قبل حقنة إنسولين أخرى بست دقائق.

معلومات عن Novo Nordisk Mallya / Mallya®D

تكتشف هذه الأجهزة الجرعات الأولية وتبلغ Glooko بها مباشرة. للحصول على معلومات مفصلة حول كيفية تحديد كل جهاز للجرعات الأولية والإبلاغ عنها، راجع كتيبات التعليمات الخاصة بكل جهاز وقلم.

*قد لا يكون متوفرًا في بلدك. غير متوفر حاليًا في الولايات المتحدة.

2. نظرة عامة على Population Tracker

سيختلف توافر الميزات المذكورة أدناه وفقًا لنوع اشتراكك وللمنطقة. للحصول على معلومات إضافية حول أيٍّ من الميزات المفصلة هنا، اتصل بممثل حساب Glooko مباشرةً أو [أرسل لنا بريداً إلكترونياً](#).

1.2. إنشاء حسابات المرضى

إذا كان المريض جديداً في عيادتك، فيتوفر لك خيار إنشاء حساب مريض جديد من قائمة المرضى.

لإنشاء حساب مريض:

1. انقر فوق إنشاء حساب مريض في أعلى يمين الشاشة.

2. أدخل المعلومات التالية:

- الاسم الأول
- الاسم الأخير
- تاريخ الميلاد
- عنوان البريد الإلكتروني*
- الرمز البريدي
- رقم السجل الطبي (اختياري، ولكن قد يكون مطلوباً لعيادتك المحددة)
- رقم الهاتف*
- نوع مرض السكري (اختياري)
- الجنس (اختياري)
- Care Program (اختياري)

* ملاحظة: يمكن إغفال عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف حتى لو كانا حقليين مطلوبين. لتجاوز هذين الحقليين، حدد المربع "رفض" أسفل الحقل وحدد السبب وراء عدم توفير هذه المعلومات. إذا كنت تقوم بإنشاء حساب خارج الولايات المتحدة، فستحتاج أيضاً إلى تأكيد موافقة المريض على مشاركة البيانات.

3. انقر فوق إنشاء.

- سيتلقى المريض رسالة بريد إلكتروني تحتوي على رابط لتعيين كلمة مرور للحساب الجديد.

×

إنشاء مريض جديد

* يشير إلى حقل مطلوب

إنشاء حساب

أملأ الحقول أدناه لإنشاء حساب مريض جديد.

* الاسم الأول

اسم المريض الأول

* الاسم الأخير

اسم عائلة المريض

* تاريخ الميلاد

YYMMDD

* الرمز البريدي

نوع مرض السكري

تحديد...

دعوة المريض للاتصال عن بُعد بالعيادة

عندما يلزم المرضى إلى Glooko، يمكنهم مزامنة بيانات الجهاز الخاصة بهم عن بُعد في المنزل. سيتمكن المرضى بإمكانية الوصول إلى أدوات مجانية لإدارة مرض السكري ومحتويات تعليمية لتحسين الالتزام وتحسين النتائج.

* عنوان البريد الإلكتروني

email@example.com

☐ رفض إضافة عنوان بريد إلكتروني (غير موصى به)

رقم الهاتف

1+ () - - - - -

المعلومات الطبية

رقم السجل الطبي

الجنس

تحديد...

Care Program


تحديد...

إنشاء

إلغاء

2.2. مرضى ProConnect

يمكن العثور على رمز ProConnect الفريد الخاص بعيادتك في أعلى يمين الشاشة الرئيسية من Population Tracker. لتمكين المرضى من مشاركة بيانات مرض السكري الخاصة بهم مع العيادة عن بُعد، يجب أن تزودهم عيادتك بالرمز الفريد الخاص بك لهم ليقيموا بإضافته إلى حسابات مرضى Glooko الخاصة بهم.

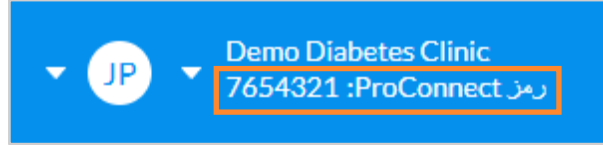

3.2. وضع الوسوم على المرضى

من قائمة المرضى أو أعلى صفحة المرضى، انقر فوق رمز زائد (+) لإنشاء علامة مخصصة أو إضافة علامة مخصصة موجودة أو إضافة علامة مقدم. إذا وضعت علامة المقدم، فيمكنك تمرير الماوس فوق العلامة لعرض اسم المقدم واسم عائلته. يمكنك إضافة وسوم مقدم متعددة إلى حساب كل مريض. ويمكنك أيضًا إنشاء وسوم مخصصة وتصفية المرضى بالاستناد إلى هذه الوسوم وغيرها من السمات الأخرى من خلال النقر فوق الزر كل أدوات التصفية في أعلى يسار قائمة المرضى.

الوسوم	الوقت في التطبيق	تعر مزامنة	المرضى
+	%23	منذ 2 من الأيام OneTouch Verio Flex	Lucy Test 1987.03.14 إنشاء

وضع علامة كمراجع

ملف التعريف

Lucy Test

تاريخ الميلاد: 1987.03.14 :MRN ABCDEF مرض السكري: النوع 1

+

الوسوم

تصدير إلى ملف CSV | إنشاء تقرير PDF

4.2. تصفية وتقسيم المرضى

تحت عرض المرضى، يتضمن Population Tracker لوحة تصفية متطورة صُممت خصيصاً لتلبية احتياجاتك ودعم سير العمل لديك بكفاءة أعلى.

The screenshot shows the Glooko Population Tracker interface. At the top, there's a header with the Glooko logo, a search bar for patient names, and a dropdown for the clinic name (Demo Diabetes Clinic). Below the header, there's a navigation bar with tabs for 'إشياء مريض' (Patient Things), 'عرض المرضى' (View Patients), 'تحليل الأجهزة' (Device Analysis), and 'لوحة المعلومات' (Information Dashboard). The 'عرض المرضى' tab is selected. Below the navigation bar, there's a table of patients. The table has columns for 'كل عوامل التصفية' (All Filtering Factors), 'المجموعات' (Groups), 'الوسوم' (Tags), and 'الحسابات المكررة' (Duplicate Accounts). The 'كل عوامل التصفية' column is highlighted with a red box.

- أدوات التصفية السريعة: يمكنك استخدام أدوات التصفية المحددة مسبقاً في أعلى القائمة لعرض الفئات ذات الأولوية القصوى بشكل فوري، مثل المجموعات* والوسوم والحسابات المكررة*.
- زر "كل أدوات التصفية":
 - المجموعات*: تصفية النتائج بناءً على المجموعات التي حفظتها مسبقاً.
 - حالة التعرض للخطر:
 - فئات مخاطر الجلوكوز: تصفية النتائج حسب فئات المخاطر المحددة مسبقاً (مثل، الارتفاع أو الانخفاض الشديد، أو الانخفاض الحاد في الوقت في النطاق المستهدف، وغيرها). يمكنك تمرير مؤشر الماوس فوق أي فئة لعرض التعريفات الدقيقة والحدود الخاصة بها.
 - الوسوم: تصفية النتائج حسب الوسوم التي تم إنشاؤها مسبقاً من قبل عيادتك.
 - إدارة الحساب:
 - حالة حساب المريض لدى Glooko: التصفية حسب حالة الحساب مُنشّط، أو دعوة معلقة، أو لم تتم الدعوة.
 - إنشاء حساب: التصفية حسب نطاق زمني محدد (مثل، في أي وقت أو خلال آخر 7 إلى 180 يوماً).
 - تنظيم البيانات: التصفية حسب الحسابات المكررة* أو عدم الارتباط بسجل EHR*.
 - الأجهزة: التصفية حسب آخر مزامنة وفئة الجهاز.
 - إدارة الرعاية: التصفية حسب مقدم الخدمة وبرامج الرعاية (إن وُجدت).
 - المعلومات الديموغرافية: التصفية حسب نوع مرض السكري والعمر.
- بعد اختيار المعايير المطلوبة من قائمة كل أدوات التصفية، اضغط على تطبيق. ستحدّث قائمة المرضى لتظهر فقط أولئك الذين تنطبق عليهم شروط التصفية المختارة.

* ملاحظة:

- لا تظهر أداة تصفية المجموعات إلا إذا كانت هذه الخاصية مضافة إلى اشتراكك. لمزيد من المعلومات حول المجموعات، يُرجى مراجعة القسم 8. إنشاء مجموعات المرضى (ميزة إضافية).
- خيار الحسابات المكررة يظهر فقط إذا كنت تملك صلاحيات مسؤول في عيادتك.
- خيار عدم الارتباط بسجل EHR يظهر فقط إذا كان لدى عيادتك ربط نشط بنظام EHR.
- لن تُحفظ أدوات التصفية المُطبقة بعد تسجيل الخروج.

5.2. الدعوة من قائمة المرضى

إذا لم يتم تنشيط حساب، فسيُتوفر لك خيار الدعوة الذي يؤدي إلى تشغيل طلب تنشيط يتم إرساله إلى المريض عبر البريد الإلكتروني لإعداد حساب Glooko شخصي. وإذا سبق أن تم إرسال طلب تنشيط إلى المريض، فيتوفر لك خيار إعادة إرسال الدعوة و/أو تحرير عنوان البريد الإلكتروني الموجود.

المريض	آخر مزامنة	الوسوم
George Testerson	1973/03/03	+
إعادة إرسال الدعوة		

6.2. إدارة إعدادات المقدم

يمكنك الوصول إلى إعدادات المقدم من خلال تحديد الإعدادات من القائمة المنسدلة في أعلى يمين الشاشة الرئيسية من Population Tracker. ويتوفر لك خيار تحديث معلومات ملف التعريف والحساب وعرض ملف تعريف الموقع وإدارة إعدادات البيانات وإعدادات الطرفية.

The screenshot shows the Glooko user profile settings page for Marcus Andrews. The page is divided into three main sections: 'ملف تعريفى' (My Profile), 'الحساب' (Account), and 'ملف تعريف الموقع' (Location Profile). The 'ملف تعريفى' section includes fields for 'الاسم الأول' (First Name) and 'الاسم الأخير' (Last Name), both set to 'Marcus' and 'Andrews' respectively. There is a 'حفظ' (Save) button below these fields. The 'الحساب' section includes fields for 'عنوان البريد الإلكتروني' (Email Address) set to 'drmarcus@example.com', 'كلمة المرور' (Password) masked with asterisks, and 'اللغة' (Language) set to 'الإنجليزية' (English). There are links for 'تغيير البريد الإلكتروني' (Change Email Address) and 'تغيير كلمة المرور' (Change Password). The 'ملف تعريف الموقع' section includes fields for 'الموقع' (Location) set to 'Demo Diabetes Clinic', 'المجموعة' (Group) set to 'Demo Diabetes Clinic PG', and 'رمز ProConnect' (ProConnect Code) set to '7654321'. There is a 'التواصل مع الموقع' (Contact Site) button below these fields. A dropdown menu is open at the top left, showing 'الإعدادات' (Settings) as the selected option, with other options being 'مساعدة' (Help) and 'تسجيل خروج' (Logout).

ملف تعريفى

في الإعدادات > ملف تعريفى، يمكنك تحرير المسمى الوظيفي والاسم الأول واسم العائلة. انقر فوق **حفظ** لتسجيل أي تغييرات.

الحساب

في الإعدادات > الحساب، يتوفر لك خيار تحديث إعدادات عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور واللغة الافتراضية المقترنة بحسابك.

ملف تعريف الموقع

في الإعدادات > ملف تعريف الموقع، يمكنك عرض موقع العيادة والمجموعة و**رمز ProConnect** وجهة الاتصال التابعة للموقع.

إعدادات البيانات

في الإعدادات < إعدادات البيانات، يتوفر لك خيار ضبط طريقة عرض بيانات المريض على مستوى مجموعة المرضى، ويشمل ذلك وحدة القياس وإعدادات إدخال مضخة جلوكوز الدم ونطاقات العيادة الافتراضية لجلوكوز الدم لمرض السكري ومعلومات وسوم مجموعة المرضى. انقر فوق **حفظ** لتسجيل أي تغييرات.

إعدادات البيانات

وحدة القياس ☒ مجم/ديسيلتر ☐ mmol/L

استعادة الإحداثيات الافتراضية

إعدادات إدخال جلوكوز الدم بالمضخة

تضمن في الإحصاءات ☒ نعم ☐ لا

Demo Diabetes Clinic نطاق الجلوكوز في الدم المستهدف الافتراضي

لدى المرضى الجدد الذين تم إنشاؤهم لنطاق الجلوكوز في الدم المستهدف التالي:

الحد الأدنى 70 مجم/دسل

الحد الأعلى 130 مجم/دسل

الحد الأعلى بعد الوجبة 180 مجم/دسل

تم التغيير من قبل Jessica Providerly يوم 2026-11-09 9:58 صباحًا

إعادة تعيين نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة لجميع المرضى

يمكن للمرضى أو مقدمي الرعاية تعديل نطاقات جلوكوز الدم الفردية من ملف تعريف المريض، ولذلك، قد تكون للمرضى الحاليين نطاقات مستهدفة لجلوكوز الدم مختلفة عن نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة الافتراضية لـ Demo Diabetes Clinic. سيتم لك "إعادة تعيين جميع نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة" تعيين النطاقات الافتراضية لـ Demo Diabetes Clinic لجميع المرضى مرة واحدة.

إعادة تعيين جميع نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة

حفظ

إعدادات الجهاز

أجهزة الإرسال

الرقم التسلسلي.	تاريخ آخر فحص للإشارة	قوة الإشارة	جودة الإشارة	الاسم
S17540231	2022-11-15 15:08:28	غير متوفر	غير متوفر	S17540231

حفظ

يتم عرض الإعدادات التالية:

- **وحدة القياس:** يمكن التبديل إلى **مجم/ديسيلتر** أو **ميللي مول/لتر**. وبالنسبة إلى المستخدمين في كندا، يتم قفل هذا الإعداد عند ميللي مول/لتر ولا يمكن تغييره إلى مجم/ديسيلتر.
 - **ملاحظة:** سيؤدي ضبط هذا الإعداد إلى تحديث عرض الوحدة في Population Tracker لعلامات جلوكوز الدم لكنه لن يؤدي إلى تحديث بيانات جهاز المريض.
 - **إعدادات إدخال مضخة جلوكوز الدم:** يمكن تبديلها إلى **نعم** أو **لا** لتضمن قراءات جلوكوز الدم التي يتم إدخالها يدويًا في مضخات الإنسولين في الرسوم البيانية والإحصاءات أو استبعادها منها لمجموعة المرضى كلها لديك. ويتم تضمين هذه القراءات بشكل افتراضي.
 - **ملاحظة:** يمكنك أيضًا ضبط ذلك على مستوى المريض في إعدادات المريض < **إعدادات البيانات**. وتولى الأولوية دائمًا إلى الإعدادات على مستوى المريض قبل الإعدادات على مستوى مجموعة المرضى.
 - **نطاق جلوكوز الدم المستهدف الافتراضي للعيادة:** يسمح ذلك للمسؤول في عيادتك بتغيير نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة لكل حسابات المرضى الجديدة، بما في ذلك الحد الأدنى، والحد الأقصى قبل الوجبة، والحد الأقصى بعد الوجبة.
 - **ملاحظة:** يمكن أيضًا تغيير نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة على المستوى الفردي في إعدادات المريض < **إعدادات البيانات**. وتولى الأولوية دائمًا إلى الإعدادات على مستوى المريض قبل الإعدادات على مستوى مجموعة المرضى. لتعيين نطاق جلوكوز الدم المستهدف الافتراضي في العيادة لكل المرضى، يجب عليك النقر فوق **إعادة تعيين كل نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة**. إعدادات الطرفية
- في الإعدادات < إعدادات الطرفية، يتوفر لك خيار ضبط اسم (أسماء) جهاز (أجهزة) Glooko Transmitter وأداة (أدوات) Uploader وعرض أدوات التحميل المقترنة حاليًا بحسابك. تنعكس كل التغييرات في علامة التبويب "تعيين الأجهزة" في Population Tracker.
- وفي حال إدراج أجهزة الإرسال Glooko في حسابك، سيتم عرض الرقم التسلسلي وتاريخ آخر تحقق من الإشارة وقوة الإشارة وجودة الإشارة والاسم. أما في حال إدراج أدوات تحميل Glooko في حسابك، سيتم عرض الرقم التسلسلي والاسم.
- ويمكن ضبط أسماء أجهزة الإرسال Glooko وأدوات Uploader من خلال النقر فوق **حقل الاسم الخاص بالأداة** التي تريد ضبطها وإدخال اسم جديد. انقر فوق **حفظ** لتسجيل أي تغييرات.

إعدادات PDF المفضلة

في الإعدادات < إعدادات PDF المفضلة، يمكنك عرض ملفات تعريف مفضلة جديدة أو تعديلها أو إضافتها. تتم إضافة الإعدادات المفضلة على مستوى مجموعة المرضى كلها وتظهر في القائمة المنسدلة إعدادات PDF المفضلة عند إنشاء **تقرير PDF** من حساب أي مريض.

لإضافة إعداد مفضل جديد، انقر فوق **+ مفضل جديد**، وأدخل اسم ملف تعريف مفضل (انقر فوق موافق)، وحدد نطاق وقت ثم حدد التقارير التي يجب تضمينها، واختر وضع الطباعة وانقر فوق **حفظ**.

إعدادات PDF المفضلة

+ مفضل جديد

الاسم

7.2. إدارة إعدادات المريض

في إعدادات المريض، يتوفر لك خيار تحديث معلومات ملف تعريف المريض الفردي؛ وعرض البريد الإلكتروني للحساب أو إرسال طلبات التنشيط؛ وتخصيص إعدادات البيانات؛ وتعيين نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة، ومعلومات العلامات ونطاقات الوقت اليومية؛ وتحميل نظام

Omnipod؛ وتوصيل أجهزة i.Glucose. ستتعرض كل التغييرات في حساب Glooko الخاص بالمريض.

لعرض إعدادات حساب المريض أو تحديثها، قم بما يلي:

1. اعر على مريض أو ابحث عنه في قائمة المرضى.
2. انقر فوق اسم المريض ليتم نقله إلى شاشة ملخص المريض.
3. انقر فوق ملف التعريف إلى جانب اسم المريض.

الاسم

glooko

أدخل اسم المريض

الاسم

المحفوظات

السجل

الرسومات البيانية

الملخص

ملف التعريف

Lucy Test

تاريخ الميلاد: 1970.01.01

MRN: 654321

مرض السكري: النوع 1

+ الوسوم

إنشاء تقرير PDF

تحميل بيانات PDM Omnipod®

نسخ الإ

الوقت:

أسبوعان

القرارات:

جلوكوز الدم

جهاز المراقبة

ملف التعريف

في إعدادات المريض < ملف التعريف، يمكنك عرض المعلومات الديموغرافية الخاصة بالمريض وتعديلها، ويشمل ذلك الاسم والجنس ونوع مرض السكري وتاريخ الميلاد والطول والوزن ورقم السجل الطبي. انقر فوق **حفظ** لتسجيل أي تغييرات.

ملف تعريف Sally Testing

الاسم الأول	الاسم العائلة	تاريخ الميلاد	رقم السجل الطبي	الجنس	الطول	الوزن	نوع مرض السكري	الرمز البريدي	رقم الهاتف
Sally	Testing	1 فبراير 1983		أنثى	0 قدم 0	0 رطل	النوع 2	12345	966+ () - - - - -

الحساب

في إعدادات المريض < الحساب، يمكنك عرض حالة حساب مريض وإضافة عنوان البريد الإلكتروني أو تغييره أو عرضه في الملف. إذا لم يتم تنشيط حساب (الحالة: غير منشط)، فيتوفر لك خيار **إضافة عنوان بريد إلكتروني** الذي يؤدي إلى إرسال طلب تنشيط إلى المريض عبر البريد الإلكتروني لإعداد حساب Glooko شخصي. إذا سبق أن تم إرسال طلب تنشيط إلى المريض (الحالة: تمت دعوته)، فيتوفر لك خيار **إعادة إرسال الدعوة** أو **تغيير البريد الإلكتروني**، ما سيؤدي إلى إرسال طلب آخر. بمجرد أن يقوم مريض بتنشيط حساب (الحالة: منشط)، لن يعود خيار تغيير عنوان البريد الإلكتروني متوفرًا لك.

الحساب

الحالة	البريد الإلكتروني
تمت الدعوة (2023/08/15)	sally.testing@example.com
إعادة إرسال الدعوة	تغيير البريد الإلكتروني

إعدادات البيانات

في إعدادات المريض < إعدادات البيانات، يمكنك ضبط وحدة القياس وإعدادات إدخال مضخة جلوكوز الدم ونطاقات جلوكوز الدم المستهدفة وإعدادات العلامات ونطاقات الوقت اليومية الخاصة بالمريض. انقر فوق **حفظ** لتسجيل أي تغييرات.

يتم عرض الإعدادات التالية:

- **وحدة القياس:** يمكن التبديل إلى **مجم/ديسيلتر** أو **ميلي مول/لتر**. وبالنسبة إلى المستخدمين في كندا، يتم قفل هذا الإعداد عند ميلي مول/لتر ولا يمكن تغييره إلى **مجم/ديسيلتر**.

- **إعدادات إدخال مضخة جلوكوز الدم:** يمكن تبديلها إلى **نعم** أو **لا** لتضمين قراءات جلوكوز الدم التي يتم إدخالها يدوياً في مضخات الإنسولين في الرسوم البيانية والإحصاءات أو استبعادها منها. ويتم تضمين هذه القراءات بشكل افتراضي.

ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط إعدادات إدخال مضخة جلوكوز الدم لجميع المرضى على مستوى مجموعة المرضى في إعدادات المقدم < [إعدادات البيانات](#). وتولى الأولوية دائماً إلى الإعدادات على مستوى المريض قبل الإعدادات على مستوى مجموعة المرضى.

- **نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة:** يسمح لك ذلك بتغيير نطاقات جلوكوز الدم المستهدفة لمريض معين، بما في ذلك الحد الأدنى والحد الأقصى قبل الوجبة والحد الأقصى بعد الوجبة. لتحرير هذه النطاقات، انقر داخل حقل القيمة التي يجب تعديلها وأدخل القيمة المطلوبة.
- **نطاقات الوقت اليومية:** تتيح لك تعيين أوقات اليوم التي تشير إلى بداية روتين الصباح وبعد الظهر والمساء والليل لدى المريض. ولتحديث النطاقات للمريض، انقر فوق **السهم لأسفل (▼)** إلى جانب أي وقت من أوقات اليوم وحدد وقت بداية جديداً.

الأجهزة

من إعدادات المريض < الأجهزة، يتوفر لك خيار تحميل البيانات من نظام Omnipod® الخاص بالمريض أو توصيل جهاز (أجهزة) iGlucose الخاص بالمريض أو تحميل بيانات LibreView الخاصة بالمريض إلى Glooko.



تحميل بيانات Omnipod® PDM

لتحميل بيانات من نظام Omnipod:

1. في إعدادات المريض < الأجهزة، انقر فوق **تحميل Omnipod® PDM**.
 2. عند مطالبتك بتأكيد رغبتك في المتابعة، انقر فوق **متابعة**.
 3. حدد نظام **Omnipod® PDM** أو نظام **Omnipod DASH™**، ثم انقر فوق **التالي**.
ملاحظة: إذا كنت تحاول مزامنة نظام Omnipod DASH™ على كمبيوتر Mac، فستتم مطالبتك بتنصيب **Glooko Uploader** لمزامنة بيانات المريض إذا كان ذلك مضمناً في نوع الاشتراك الخاص بك. أما إذا لم يكن نوع الاشتراك الخاص بك يتضمن Glooko Uploader، فستتم مطالبتك باستخدام كمبيوتر يعمل بنظام Windows أو الاتصال بـ support@glooko.com.
 4. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتوصيل الجهاز وتحميل البيانات.
- ملاحظة:** إذا سبق أن قام المريض بمزامنة جهاز Omnipod، فسيتم توفير لك خيار تحميل بيانات Omnipod من خلال تحديد خيار **تحميل Omnipod® PDM** في أعلى يمين معظم الشاشات في حساب المريض.

توصيل أجهزة iGlucose

يمكنك توصيل جهاز (أجهزة) قياس iGlucose خاص بالمريض بحساب Glooko لمزامنة البيانات من iGlucose في الوقت الحقيقي.

ملاحظة: قبل توصيل جهاز قياس iGlucose بـ Glooko، يجب أن تتوفر لدى المريض قراءة واحدة على الأقل على جهاز القياس.

لتوصيل جهاز قياس iGlucose:

1. في إعدادات المريض < الأجهزة، انقر فوق **توصيل أجهزة iGlucose**.
2. أدخل الرقم التسلسلي لجهاز قياس iGlucose الخاص بالمريض وآخر قراءة (القيمة)، ثم انقر فوق **التالي**.
3. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتوصيل جهاز القياس.

تحميل بيانات *LibreView

لتحميل ملف LibreView بتنسيق CSV إلى حساب Glooko الخاص بالمريض:

1. من إعدادات المريض < الأجهزة، انقر فوق **تحميل بيانات LibreView**.
2. اتبع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتحميل ملف CSV.
3. تأكد من تحميل بيانات CSV إلى حساب Glooko الصحيح.
4. انقر فوق زر **عرض البيانات** لتتم إعادة توجيهك إلى **تعيين الأجهزة**، حيث يجب تعيين البيانات للمريض.

***قد لا يكون متوفرًا في بلدك.**

إدارة الحساب

كيفية أرشفة حساب المريض:

في إعدادات المريض < إدارة الحساب، قم بتشغيل خيار أرشفة حساب مريض. بمجرد أرشفة حساب مريض، سيتوقف عرض ذلك المريض في قائمة المرضى، ولكن سيستمر المريض في الظهور في نتائج البحث.

كيفية أرشفة حساب المريض:

في إعدادات المريض < إدارة الحساب، اضغط على زر إزالة الحساب. بمجرد إزالة حساب المريض، لن يعود من الممكن لعيادتكم الوصول إلى هذه البيانات أو عرضها.

إدارة الحساب

أرشفة حساب المريض

سيُتوقف عرض المريض تلقائيًا في قائمة المرضى. سيستمر عرضه في نتائج البحث

أرشفة مريض

ملاحظة: يمكن للمسؤولين فقط الوصول إلى أرشفة حسابات المرضى وإزالتها.

3. نظرة عامة على التقارير

يتم تجميع بيانات مرض السكري الخاصة بالمرضى في تقارير PDF تمكن طباعتها أو مشاركتها أو حفظها بسهولة. ويمكنك تضمين كافة البيانات المتوفرة فيها أو اختيار البيانات التي تريد عرضها فقط.

للحصول على معلومات مفصلة حول التقارير المتوفرة وكيفية تفسير البيانات، راجع [دليل التقارير المرجعي من Glooko](#).

1.3. التقارير المتوفرة

تتضمن التقارير المتوفرة ما يلي:

- الملخص
- السجل
- النظرة العامة
- النظرة العامة اليومية
- التراكب
- عرض الأسبوع
- التقويم
- الأجهزة
- المعلومات المعقدة

2.3. إنشاء التقارير

لإنشاء تقرير PDF، اتبع الخطوات التالية:

1. من قائمة المرضى، انقر فوق اسم المريض ليتم توجيهك إلى شاشة ملخص المريض. انقر فوق إنشاء تقرير PDF في أعلى يسار معظم الشاشات في حساب المريض.
2. حدد نطاق التواريخ والتقارير التي يجب تضمينها ووضع الطباعة المطلوب.

ملاحظة: لحفظ تقرير محدد كملف تعريف مفضل جديد، ضع علامة صحيح (✓) في مربع حفظ الخيار المحدد كملف تعريف مفضل، وأدخل اسمًا للإعداد المفضل وانقر فوق موافق. إضافة إلى ذلك، يتوفر لك خيار تحديد ملف تعريف مفضل من القائمة المنسدلة إعدادات PDF المفضلة في أعلى يمين النافذة. لعرض ملفات تعريف مفضلة جديدة أو تعديلها أو إضافتها، انقر فوق إدارة الإعدادات المفضلة أو انتقل إلى إعدادات المقدم < [إعدادات PDF المفضلة](#).

3. بعد تعريف معايير التقارير وبمجرد أن تصبح جاهزاً للمتابعة، انقر فوق إنشاء ملف PDF.

إغلاق

إنشاء ملف PDF

Lucy Test

تاريخ الميلاد: 70/01/01

مرض السكري: النوع 1

الوقت: أسبوعان

2023/08/15 - 2023/08/02

إعداد PDF المفصلة

لم يتم تحديد ملف تعريف

إدارة المفصلة

عرض الأسبوع

نظرة عامة يومية

نظرة عامة

السجل

الملخص

الأجهزة

المعلومات المعقدة

التقرير

التركيبة

2 صفحة

4

طول التقرير المقدر: 4

وضع الطباعة: أبيض وأسود

ألوان

اكتب التعليق هنا! ستظهر التعليقات في قسم التقرير الملخص.

حفظ الاختيار كملف تعريف افتراضي

إنشاء ملف PDF

4. الدعم

إذا كانت لديك أي أسئلة، فسُتسر دائمًا بمساعدتك. يمكنك التواصل معنا بأيّ من الطرق التالية:

- الدعم عبر الويب: www.support.glooko.com
- الدعم عبر البريد الإلكتروني: help@glooko.com

ينبغي إبلاغ فريق دعم Glooko والسلطة المختصة في الدولة العضو التي توجد فيها أنت و/أو مريضك بأي حادث خطر وقع في ما يخص الجهاز.

في حال وجود خلل في Glooko System، يُرجى التوقف عن استخدام المنتج والاتصال بدعم Glooko. وتتضمن الأمثلة على الأعطال إضافة بيانات الجهاز بشكل غير صحيح للمريض، وبيانات وقت جهاز غير صحيحة، ووحدة قياس غير صحيحة.

REF-0002 **REF**

REF-0001 **REF**

EC **REP**

MD

CE
2862



MedEnvoy Global B.V
Prinses Margrietplantsoen 33 - Suite 123
2595 AM The Hague
The Netherlands

Glooko Inc.
579 University Avenue
Palo Alto, CA 94301
USA

الملحق 1: الميزات الإضافية

تتوفر الميزات أدناه كخيارات إضافية لاشتراكك في Population Tracker. للحصول على مزيد من المعلومات أو تعلم كيفية إضافة هذه الميزات إلى Population Tracker، اتصل بممثل حساب Glooko مباشرةً أو [أرسل لنا بريدًا إلكترونيًا](#).

أ. 1. إخفاء قائمة المرضى


تتيح ميزة إخفاء قائمة المرضى للمستخدمين المحترفين إخفاء قائمة المرضى أو إظهارها باستخدام مفتاح تبديل. عند تمكين هذه الميزة، تضمن للطبيب ألا يستطيع المريض خلال موعد في العيادة رؤية قائمة المرضى عن غير قصد والاطلاع على المعلومات الصحية المحمية (PHI) للمرضى الآخرين.

Clinic connect		الاسم		اختر اسم المريض	
				إخفاء قائمة المرضى	
				عرض المرضى	
				تعيين الأجهزة	
				تصفية المرضى 1-13 من 13	
				آخر مراجعة	
				الوقت في التطبيق	
				العلامات	
				أمر تفعيل 24-09-2024	
				اليوم	
				Ascensia CONTOUR NEXT ONE	
				اليوم	
				FreeStyle Insulinx	
				اليوم	
				OneTouch Verio	
				اليوم	
				Sally Testing	
				1983.02.01 إعادة إرسال الدعوة	

أ.2. نسخ الإحصاءات الأساسية*

تسمح لك ميزة نسخ الإحصاءات الأساسية بنسخ معلومات المريض الأساسية (مثل البيانات الديموغرافية للمريض وتفاصيل الأجهزة وإعدادات المضخة وبيانات الجلوكوز)، إذا كانت متوفرة، من حسابات المرضى بتنسيق نص عادي.

وعند تمكين ميزة نسخ الإحصاءات الأساسية، يمكنك النقر فوق زر **نسخ الإحصاءات الأساسية** الذي سيتم عرضه في أعلى يمين شاشة الملخص والأجهزة في حسابات المرضى لنسخ المعلومات الموجودة على هذه الشاشات إلى الحافظة.

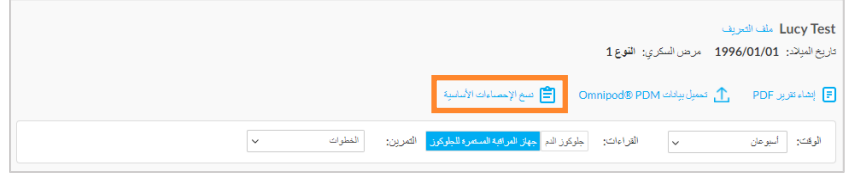The screenshot shows a web interface for 'Lucy Test'. At the top right, it says 'ملف التحريف Lucy Test' and 'تاريخ الميلاد: 1996/01/01' and 'مرض السكري: النوع 1'. Below this, there are three buttons: 'إنشاء تقرير PDF', 'تحميل بيانات PDM Omnipod®', and 'نسخ الإحصاءات الأساسية' (highlighted with an orange box). At the bottom, there are several dropdown menus and a 'الخطوات' button.

ملاحظة: بما أن هذه الميزة تنسخ معلومات صحية محمية (PHI) إلى الحافظة، توصي Glooko باتتباع القواعد المعمول بها في مؤسستك لمعالجة هذه المعلومات.

* قد لا يكون متوفرًا في بلدك.

أ.3. Glooko Clinical Research*

تسمح ميزة Glooko Clinical Research لعيادتك بمراقبة المشاركين في الأبحاث ضمن Population Tracker.

ملاحظة: لإبقاء حسابات المشاركين في الأبحاث منفصلة عن حسابات المرضى الموجودة لديك، يتم تعيين رمز ProConnect جديد لعيادتك لأغراض الأبحاث خصيصًا، ويُطلب من مستخدمي العيادة لديك استخدام حسابات منفصلة للوصول إلى المنصة. ولإشراك المشاركين في الأبحاث ببياناتهم، سيحتاجون إلى استخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

1. تحميل البيانات إلى منصة Glooko Clinical Research باستخدام برنامج [Glooko Research Uploader](#).

2. تنزيل تطبيق Glooko Clinical Research على الهاتف المحمول واتصل باستخدام رمز ProConnect المخصص لـ Clinical Research.

معرف المشارك

عند تنشيط ميزة Glooko Clinical Research، يتوفر لك خيار إدخال **معرف المشارك** كجزء من سير عمل مهمة **إنشاء حساب المريض**. ويمكنك استخدام معرف المشارك لتتبع المشاركين في الأبحاث لديك. بالإضافة إلى ذلك، تستطيع البحث باستخدام معرف المشارك في Population Tracker.

×

إنشاء مريض جديد

*يُنظر إلى حل مطلوب

إنشاء حساب
أملأ الحقول أدناه لإنشاء حساب مريض جديد.

*مرفق المشارك

إخراج مريض

في إعدادات المريض، يتيح لك قسم الحساب الجديد إمكانية **إخراج مريض** التي تسمح بإزالة مشاركتك في الأبحاث من دراسة البحث السريري وإلغاء تنشيط حسابه.

الحساب

حالة المريض

مدعو

إخراج مريض

Research Uploader

أثناء استخدام Glooko Clinical Research، تستطيع عيادتك الوصول إلى أداة Research Uploader منفصلة تم تصميمها خصيصًا لتحميل بيانات أجهزة المشاركين في الأبحاث إلى منصة Glooko Clinical Research.

* قد لا يكون متوفرًا في بلدك.

أ.4. التحقق على خطوتين

تسمح ميزة التحقق على خطوتين لعيادتكم بطلب نموذجي مصادقة من المستخدمين المحترفين الذين يحاولون الوصول إلى حساباتهم. ويضيف ذلك طبقة إضافية من الأمان لعيادتكم ولبيانات المرضى لديكم.

وعند تمكين هذه الميزة، سيتلقى المستخدم كلمة مرور صالحة لمرة واحدة (OTP) عبر البريد الإلكتروني أو المصادقة عبر التطبيق، ويتعين عليه إدخال كلمة المرور هذه عند تسجيل الدخول إلى Population Tracker. يتوفر للمستخدم خيار حفظ كلمة المرور الصالحة لمرة واحدة لمدة 30 يومًا؛ وإذا لم يختَر ذلك، فسيتم طلب كلمة مرور صالحة لمرة واحدة في كل مرة يحاول فيها الوصول إلى حسابه.

ملاحظة: وحده المسؤول يستطيع إدارة هذا الإعداد لكل المستخدمين المحترفين في العيادة. ولكن قد تُفرض بعض المتطلبات التنظيمية الإقليمية/الوطنية التي تفرض تمكين التحقق على خطوتين دائمًا. وفي هذه الحال، لا يستطيع أي شخص في العيادة تعطيلها.

أ.5. تسجيل الدخول الأحادي

تسمح ميزة تسجيل الدخول الأحادي (SSO) للمستخدمين المحترفين لديك بتسجيل الدخول إلى حساباتهم في Population Tracker عبر خدمة مصادقة آمنة تدير الوصول إلى تطبيقات متعددة.

وعند تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الأحادي على شاشة تسجيل الدخول إلى Glooko وإدخال بيانات اعتماد حساب Glooko واتباع المطالبات التي تظهر على الشاشة لتوصيل حساباتهم.

The screenshot shows the Glooko login interface. At the top, the Glooko logo is displayed in white on a blue background, with the text 'تسهيل إدارة مرض السكري' (Facilitating Diabetes Management) below it. The main content area is white and contains a language selector dropdown set to 'العربية' (Arabic). Below this is the title 'تسجيل الدخول' (Login). There are two input fields: 'البريد الإلكتروني (اسم المستخدم)' (Email (Username)) and 'كلمة المرور' (Password), with a toggle for password visibility. A link for 'نسيت كلمة المرور' (Forgot Password) is provided. A blue button labeled 'تسجيل الدخول' (Login) is present. Below the button, a link for 'تسجيل الدخول باستخدام تسجيل الدخول الأحادي' (Login using Single Sign-On) is highlighted with an orange border. At the bottom, a note asks 'هل لديك حساب؟؟ التسجيل في Glooko هنا' (Do you have an account?? Register in Glooko here).

أ.6. Care Programs

تسمح برامج Care Programs من Glooko لعيادتك بإدارة مجموعة المرضى بمزيد من الفعالية من خلال تعيين برامج مخصصة لاحتياجات مرض السكري المحددة. وتوفر هذه البرامج لك ولمرضائك موارد مفيدة لفهم أنواع مرض السكري الفريدة التي يعانون منها وتوجيهات لاستخدام Glooko لتحسين إدارة مرض السكري.

وعند تمكين برامج Care Programs لعيادتك، يتوفر لك خيار تعيين البرامج للمرضى من Population Tracker. وبمجرد تعيين برنامج لمرضى ما، سيتلقى بريدًا إلكترونيًا يتضمن تعليمات الوصول إلى البرنامج عبر الإنترنت.

أ.7. حزمة الحمل

تسمح حزمة الحمل من Glooko لعيادتك بمراقبة النساء الحوامل المصابات بمرض السكري. وعند تمكين هذه الميزة، يمكن إدخال تاريخ الإنجاب المقدر في صفحة ملف تعريف المريضة. وسيؤدي ذلك إلى ظهور علامة حمل في قائمة المرضى لدى العيادة حيث يتم عرض الأسبوع + اليوم الحالي من حمل المريضة لتسهيل تتبع إدارة مرض السكري أثناء كل فترة الحمل.

وتستطيع تصفية قائمة المرضى حسب حزمة الحمل، الأمر الذي سيؤدي إلى عرض قائمة كاملة بالمريضات اللواتي يمررن في فترة حمل حاليًا.

وعند عرض حساب مريضة ما مع تاريخ إنجاب محدد، سيظهر أسبوع + يوم الحمل في صفحة الملخص والرسومات البيانية والمحفوظات أيضًا.

أ.8. إنشاء مجموعات المرضى

بإمكان العيادات التي أضافت خاصية المجموعات إلى اشتراكها حفظ مجموعات مخصصة من أدوات تصفية البحث لاستخدامها بشكل متكرر. تهدف هذه الخاصية إلى تعزيز دقة تحليل بيانات المرضى، وتخصيص التدخلات العلاجية، وتطوير سير العمل لتقديم رعاية صحية أكثر كفاءة.

بمجرد شراء العيادة لهذه الميزة الإضافية، سيقوم فريق Glooko بتنفيذ الميزة لموقعك. وبينما تتوفر ميزة التصفية الأساسية لجميع المستخدمين، فإن هذه الخاصية تُعد أداة متقدمة مخصصة لإدارة مجموعات المرضى.

- مثال: يمكنك إنشاء وحفظ مجموعة تضم المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، ولديهم بيانات جلوكوز من الأيام السبعة الماضية، وبشرط أن يكون الوقت في النطاق أقل من 50%، ونسبة نشاط خاصية CGM أكثر من 70%.

من خلال **قسم تصفية قائمة المرضى**، يمكنك لاحقاً تصفية القائمة بسرعة باستخدام المجموعة التي قمت بحفظها.

لإنشاء مجموعة جديدة:

1. انتقل إلى صفحة **الإعدادات** من القائمة العلوية اليمنى، ثم مرر للوصول إلى **المجموعات**.
2. انقر على **إنشاء مجموعة** واختر أدوات التصفية المطلوبة (راجع الصورة الموضحة جهة اليمين).
3. بعد اختيار أدوات التصفية، اضغط على **التالي**.
4. أدخل اسماً ووصفاً للمجموعة، ثم اضغط على **حفظ**.

ظهور المجموعات: يمكن لجميع المستخدمين في عيادتك عرض واستخدام المجموعات التي تم إنشاؤها؛ ومع ذلك، يقتصر حق التعديل أو الحذف على منشئ المجموعة والمسؤولين فقط.

تحديد المرضى حسب المجموعة: سيتم إضافة عمود خاص بالمجموعات إلى قائمة المرضى، يوضح كل المجموعات التي ينتمي إليها المريض حالياً. إذا استوفى المريض معايير إحدى المجموعات، فسيظهر اسم المجموعة كعلامة وسم في ملفه الشخصي، وسيكون ظاهراً أيضاً في صفحة ملخص بيانات المريض.



تصدير بيانات المجموعات: عند تفعيل أداة تصفية يحتوي على مجموعة معينة، فإن النقر على زر **تصدير إلى CSV** الموجود في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة المرضى سيؤدي إلى استخراج تقرير يتضمن فقط المرضى المدرجين في عرض التصفية الحالي.

تحديد فلاتر المجموعة

بحث

مراقبة الجلوكوز ^

تحميل إظهار الزماني لمراقبة الجلوكوز

آخر 7 أيام

آخر 14 أيام

آخر 30 أيام

آخر 90 أيام

الوقت في الشفق

الوقت في الصباح

الوقت في الظهيرة

الوقت في المساء

متوسط الجلوكوز

أي

%

60

تقلبات نشاط جلوكوز CGM %

أكثر من

%

70

% قراءات مستوى الجلوكوز

أي

%

70

حالة التعرض للخطر

لتحديد يوم التعرض للخطر في التاريخ السابق

التعرض من حالات الانخفاض الشديد

التعرض من حالات الانخفاض

مرتفع جدًا

انخفاض كبير في الوقت في الشفق

مرتفع

انخفاض الوقت في الشفق

بيانات مفقودة/غير كافية

الوسوم

Dr. whittaker

Dr. archer

Demo

Athletes

إدارة الحساب ^

حالة حساب المريض لدى Glooko

إنشاء حساب

في أي وقت

حسب

الدعوة لحالة

لم يتم الدعوة

الأجهزة ^

قائمة الأجهزة

CGM

BG

Insulin Pen

Insulin Pumps

Diabetes Accounts (Cloud)

إدارة الرعاية ^

مقدم الرعاية

M. Andrews

J. Doe

S. Fergusson

C. Goodman

K. Pendo

B. Phillips

J. Providerly

M. Williams

البيانات غير الجيئة ^

نوع مرض السكري

لا يوجد

نوع 1 ☒

نوع 2

مطلبي

معلومات مرض السكري

مرض السكري، نائي (العامة الجاني لدى البالغين)

غير ناكه

العمر

بين

من

18

سنة

إلى

10

سنة

التالي


مسح الكل

البيانات المحددة: 4

الملحق 2: ميزات خاصة بالأجهزة

ب.1. Basal-IQ

يمكن للمرضى الذين يستخدمون مضخة t:slim X2 من Tandem مع جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز تنشيط تكنولوجيا تُسمى Basal-IQ، وهي تكنولوجيا متقدمة تتنبأ بانخفاض مستوى السكر في الدم وتساعد على منع حدوثه. وتتيح تكنولوجيا Basal-IQ للمريض السماح لمضخته بإيقاف تقديم الإنسولين واستئنافه تلقائيًا استنادًا إلى قراءات جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز.

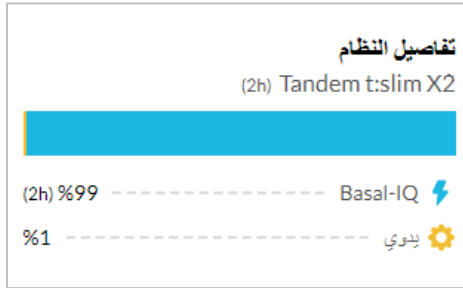


ويمكن لمريض يملك مضخة مثبتة عليها تكنولوجيا Basal-IQ الاختيار بين وضعين:

- Basal-IQ
- الوضع اليدوي

في Glooko، إذا توفرت بيانات Basal-IQ للمريض، فستظهر في صفحة الملخص على شكل بطاقة معلومات بعنوان: **تفاصيل النظام**. ويتم عرض Basal-IQ أيضًا في عرض اليوم ضمن قسم **الرسومات البيانية**.

ب.2. Control-IQ

يتوفر للمرضى الذين يستخدمون مضخة t:slim X2 من Tandem مع جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز خيار تنشيط تكنولوجيا تُسمى Control-IQ، وهي تكنولوجيا هجينة متقدمة للحلقة المغلقة تتوقع حدوث الارتفاعات والانخفاضات وتساعد على تفاديها. وتسمح تكنولوجيا Control-IQ للمريض بالسماح لمضخته بضبط مستويات الإنسولين تلقائيًا استنادًا إلى قراءات جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز.

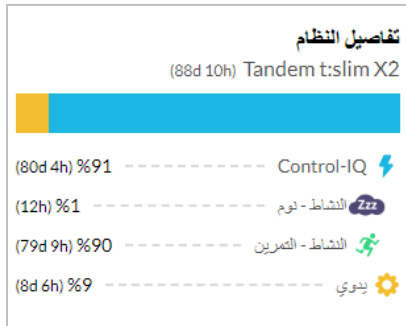


ويمكن لمريض يملك مضخة مثبتة عليها تكنولوجيا Control-IQ الاختيار بين 4 أوضاع:

- Control-IQ
- النوم
- التمارين الرياضية
- اليدوي

في Glooko، إذا توفرت بيانات Control-IQ للمريض، فستظهر في صفحة الملخص على شكل بطاقة معلومات بعنوان: **تفاصيل النظام**. ويتم عرض Control-IQ أيضًا في عرض اليوم ضمن قسم **الرسومات البيانية**.

ب.3. نظام 5 Omnipod®*

يتوفر للمرضى الذين يستخدمون مضخة Omnipod 5 مع جهاز Dexcom للمراقبة المستمرة للجلوكوز خيار تنشيط تكنولوجيا الحلقة المغلقة التي طورتها Insulet، وهي تكنولوجيا هجينة متقدمة للحلقة المغلقة تتوقع حدوث الارتفاعات والانخفاضات وتساعد على تفاديها. وبالإضافة إلى ذلك، تتيح هذه التكنولوجيا للمريض السماح لمضخته بضبط مستويات الإنسولين تلقائيًا استنادًا إلى قراءات جهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز.

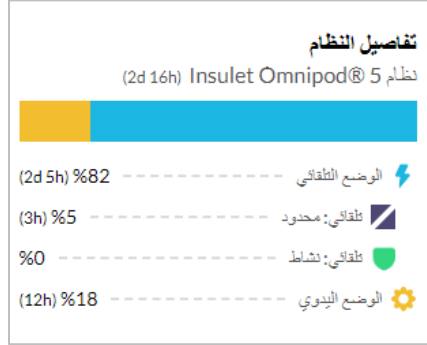

يمكن للمريض الذي يستخدم Omnipod 5 وجهاز المراقبة المستمرة للجلوكوز Dexcom الاختيار بين 4 أوضاع:

- الوضع التلقائي
- التلقائي: المحدود
- التلقائي: النشط
- الوضع اليدوي

في Glooko، إذا توفرت بيانات الحلقة المغلقة من نظام Omnipod 5 للمريض، فستظهر في صفحة الملخص على شكل بطاقة معلومات بعنوان: **تفاصيل النظام**. ويتم عرض بيانات الحلقة المغلقة أيضًا في عرض اليوم ضمن قسم **الرسومات البيانية**.

ملاحظة: نظام Omnipod 5 عبارة عن تكامل بين الشبكات السحابية. يتم إنشاء الاتصال مع Glooko على www.omnipod.com حيث يحتاج المستخدمون إلى تفويض الاتصال بين نظام Omnipod 5 و Glooko. وبمجرد إجراء الاتصال، ستتدفق البيانات بانتظام إلى Glooko مع تأخير مدته ساعة واحدة.


* قد لا يكون متوفرًا في بلدك.

ب.4. CamAPS FX *

يتمتع المرضى الذين يستخدمون مضخة متوافقة مع كل من تطبيق Glooko وتطبيق CamAPS FX بخيار استخدام التكنولوجيا الهجينة المتقدمة القابلة للتأقلم للحلقة المغلقة في كاميرا CamAPS FX التي تعمل على ضبط توصيل الإنسولين تلقائيًا إلى مضخة الإنسولين وفقًا لقراءات المستشعر للجلوكوز.

يتم عرض الأوضاع الـ 5 التالية في Glooko:

- Auto mode "تشغيل"
- Boost
- Ease-off
- جارية المحاولة
- Auto mode "إيقاف"

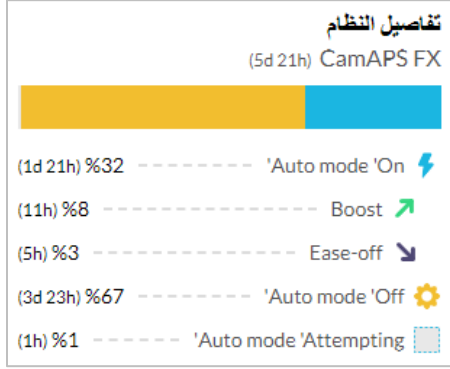

في Glooko، إذا توفرت بيانات الحلقة المغلقة من تطبيق CamAPS FX للمريض، فستظهر في صفحة الملخص على شكل بطاقة معلومات بعنوان: **تفاصيل النظام**. ويتم عرض بيانات الحلقة المغلقة أيضًا في عرض اليوم ضمن قسم **الرسومات البيانية**.

* قد لا يكون متوفرًا في بلدك.